

Pakkauseloste: Tie toa käyttäjälle

multiBic 3 mmol/l kalium, hemodialyysi-/hemofiltrationeste

Lue tämä pakkauseloste huolellisesti, ennen kuin aloitat lääkkeen käyttämisen, sillä se sisältää sinulle tärkeitä tietoja.

- Säilytä tämä pakkauseloste. Voit tarvita sitä myöhemmin.
- Jos sinulla on kysytävää, käännny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen.
- Jos havaitset haittavaikutuksia, käännny lääkärin tai sairaanhoitajan puoleen. Tämä koskee myös myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkauselosteessa. Ks. kohta 4.

Tässä pakkauselosteessa kerrotaan:

1. Mitä multiBic 3 mmol/l kalium on ja mihin sitä käytetään
2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät multiBic 3 mmol/l kalium -valmistetta
3. Miten multiBic 3 mmol/l kalium -valmistetta käytetään
4. Mahdolliset haittavaikutukset
5. multiBic 3 mmol/l kalium -valmisteen säilyttäminen
6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

1. Mitä multiBic 3 mmol/l kalium on ja mihin sitä käytetään

multiBic 3 mmol/l kalium on jatkuvan munuaiskorvaushoidon liuos, jota käytetään munuaisten vajaatoiminnassa. Sen avulla munuaispotilaan kehosta poistetaan kuona-aineita. Sitä käytetään myös munuaisvaurioiden ja myrkytysten hoidossa. Annettavan nesteen laatu riippuu veressä olevan kalumin (suolan) määrästä. Lääkäri tarkistaa potilaan kaliumtasot säännöllisesti.

2. Mitä sinun on tiedettävä, ennen kuin käytät multiBic 3 mmol/l kalium -valmistetta

Älä käytä multiBic 3 mmol/l kalium -valmistetta

- jos olet allerginen vaikuttaville aineille tai tämän lääkkeen jollekin muulle aineelle (lueteltu kohdassa 6)
- jos sinulla on hypokalemia (alhainen kaliumtaso)
- jos sinulla on metabolinen alkaloosi (liian paljon bikarbonaattia veressä)
- jos on vaikeaa saada riittävästi verta virtaamaan hemofilterin (verensuodattimen) läpi
- jos sinulla on suuri verenvuotoriski, koska veren hyytymistä estäviä lääkkeitä lisätään estämän hyytymistä hemofiltterissä.

Varoitukset ja varotoimet

Keskustele lääkärin kanssa ennen kuin käytät multiBic 3 mmol/l kalium -valmistetta.

- Valmistetta saa käyttää vasta sen jälkeen, kun kaksikammioisen pussin nesteet on sekotettu.
- Valmistetta ei missään olosuhteissa saa käyttää alle huoneenlämpöisenä.
- Käytövalmiin liuoksen antamisessa käytettävä letkusto on tarkistettava 30 minuutin välein. Jos letkustossa on sakkaa (kiinteää ainetta), pussi ja letkusto on heti vaihdettava ja potilaan tilaa on tarkkaan seurattava.
- Lääkäri tarkkailee nestetasapainoasi (veden määrä kehossasi), kalium- ja natriumtasojasi sekä muiden suolojen tasoja, tietyjen kuona-aineiden määriä ja veresi sokeripitoisuksia. Lääkäri voi myös antaa ruokavalio-ohjeita.

Lapset

multiBic 3 mmol/l kalium -valmisteen käyttöä lapsilla ei ole varmistettu.

Muut lääkevalmisteet ja multiBic 3 mmol/l kalium -valmiste

Kerro lääkärille, jos parhaillaan käytät tai olet äskettäin käyttänyt tai saatat käyttää muita lääkeitä. Mahdollisia yhteisvaikutuksia:

- digitaliksen (sydänlääke) haitalliset vaikutukset
- elektrolyytiien korvaushoito, parenteraalinen (laskimoon annettava) ravinto ja muut infuusiohoidot, joiden vaikutukset veren seerumin pitoisuksiin ja nestetilaan on otettava huomioon multiBic 3 mmol/l kalium -hoidossa
- multiBic 3 mmol/l kalium -hoito voi alentaa lääkkeiden pitoisuksia veressä, ja annoksen muuttaminen saattaa olla tarpeen.

Raskaus ja imettäminen

Jos olet raskaana tai imetät, epäilet olevasi raskaana tai jos suunnittelet lapsen hankkimista, kysy lääkäriltä neuvoa ennen tämän lääkkeen käyttöä.

Ei ole olemassa tietoja tai on vain vähän tietoja multiBic 3 mmol/l kalium -valmisten käytöstä raskauden ja imetyksen aikana.

multiBic 3 mmol/l kalium -valmistetta saa käyttää raskauden aikana vain siinä tapauksessa, että lääkäri pitää hoitoa tarpeellisenä.

Imetystä ei suositella multiBic 3 mmol/l kalium -hoidon aikana.

3. Miten multiBic 3 mmol/l kalium -valmistetta käytetään

multiBic 3 mmol/l kalium annetaan sairaalassa. Lääkäri tietää, miten täitä lääkettä käytetään.

Jos sinulla on kysymyksiä tämän lääkkeen käytöstä, käänny lääkärin puoleen.

4. Mahdolliset haittavaikutukset

Kuten kaikki lääkkeet, tämäkin lääke voi aiheuttaa haittavaikutuksia. Kaikki eivät kuitenkaan niitä saa.

multiBic 3 mmol/l kalium -valmisten haittavaikutukset:

- pahoinvointi
- oksentelu
- lihaskouristukset
- verenpaineen muutokset.

Kehon liialliset tai liian vähäiset nestemääränpainotilat aiheuttamia haittavaikutuksia:

- hengenahdistus
- nilkkojen ja jalkojen turvotus
- kuivuminen (esim. huimaus, lihaskouristukset, jano)
- veren poikkeavuudet (esim. veren epänormaalit suolakonsentraatiot).

Haittavaikutusten tarkka esiintymistihesys on tuntematon (koska saatavissa oleva tieto ei riitä arviointiin).

Haittavaikutuksista ilmoittaminen

Jos havaitset haittavaikutuksia, kerro niistä lääkärille tai sairaanhoitajalle. Tämä koskee myös sellaisia mahdollisia haittavaikutuksia, joita ei ole mainittu tässä pakkausselosteessa. Voit ilmoittaa haittavaikutuksista myös suoraan (ks. yhteystiedot alla). Ilmoittamalla haittavaikutuksista voit auttaa saamaan enemmän tietoa tämän lääkevalmisten turvallisuudesta.

www-sivusto: www.fimea.fi
Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea
Lääkkeiden haittavaikutusrekisteri
PL 55
00034 FIMEA

5. multiBic 3 mmol/l kalium –valmisten säilyttäminen

Ei lasten ulottuville eikä näkyville.

Älä säilytä alle 4 °C:ssa.

Säilytys kammioiden sekoittamisen jälkeen:

Käyttövalmis liuos on säilytettävä alle 30 °C:ssa ja se on käytettävä 48 tunnin kuluessa.

Älä käytä tästä läkettä etiketissä mainitun viimeisen käyttöpäivämäärän (EXP) jälkeen. Viimeinen käyttöpäivämäärä tarkoittaa kuukauden viimeistä päivää.

6. Pakkauksen sisältö ja muuta tietoa

Mitä multiBic 3 mmol/l kalium sisältää

- Vaikuttavat aineet ovat kaliumkoridi, natriumkloridi, natriumvetykarbonaatti, kalsiumklorididihydraatti, magnesiumkloridiheksahydraatti, glukoosimonohydraatti.
- Muut aineet ovat injektionesteisiin käytettävä vesi, kloorivetyhappo 25 %, hiilidioksiidi ja natriumdivetyfosfaattidihydraatti.

Lääkevalmisten kuvaus ja pakkaukoot

multiBic 3 mmol/l kalium -valmiste on kaksikammiosessa pussissa (kammioissa on erilaiset nesteet). Kammioiden nesteiden sekoittamisesta syntyy käyttövalmis liuos.

Pussissa on yhteensä 5000 ml nestettä. Käyttövalmis liuos on kirkas ja väritön.

Pussissa on HF-liitin, Luer-lock-liitin ja injektioportti sekä ulkokääre.

Pakkauskoko:

2 x 5000 ml:n pussi

Myyntiluvan haltija ja valmistaja

Myyntiluvan haltija:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Else-Kröner-Straße 1, 61352 Bad Homburg v.d.H., Saksa

Valmistaja:

Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Straße 6-8, 66606 St. Wendel, Saksa

Lisätietoja tästä lääkevalmisteesta antaa myyntiluvan haltijan paikallinen edustaja:

Fresenius Medical Care Suomi Oy, puh.: +358 9 561 650

Tämä pakkaus seloste on tarkistettu viimeksi 12.2.2018

Tietoa terveydenhuollon ammattilaisille tämän pakkausselosten lopussa.

Seuraavat tiedot on tarkoitettu vain hoitoalan ammattilaisille:

1 000 ml käyttövalmista liuosta sisältää:

Kaliumkloridi	0,2237 g
Natriumkloridi	6,136 g
Natriumvetykarbonaatti	2,940 g
Kalsiumklorididihydraatti	0,2205 g
Magnesiumkloridiheksahydraatti	0,1017 g
Glukoosimonohydraatti (Glukoosi)	1,100 g 1,000 g
K⁺	3,0 mmol/l
Na ⁺	140 mmol/l
Ca ²⁺	1,5 mmol/l
Mg ²⁺	0,50 mmol/l
Cl ⁻	112 mmol/l
HCO ₃ ⁻	35 mmol/l
Glucose	5,55 mmol/l

pH≈7,4

Teoreettinen osmolariteetti: 298 mOsm/l

Valmistetta ei saa käyttää, jos käyttövalmis liuos ei ole kirkas ja väritön ja pussi ja liittimet ovat vahingoittuneet.

Vain kertakäytöön. Käyttämättä jäändyt liuos on hävitettävä.

Käytettävä annostelupumppuja.

Käyttöohje

Hemodialyysi-/hemofiltrationeste annetaan kolmessa vaiheessa:


1. Ulkokäären poistaminen ja pussin huolellinen tarkastaminen

Ulkokääre tulee poistaa vasta juuri ennen annostelua. Muoviset pakkaukset voivat joskus vaurioitua kuljetuksen tai säilytyksen aikana. Tämä saattaa aiheuttaa kontaminaation ja mikro-organismi- tai sienikasvustoa nesteissä. Kaikki pakkaukset täytyy siksi huolellisesti tarkastaa visuaalisesti vaurioiden varalta ennen pussin kytkemistä ja hemofiltrationesteen käyttöä. Myös pienet vauriot sulkijassa, saumassa ja pakkauksen kulmissa täytyy huomioida epäpuhtauksien vaaran takia.


2. Kahden nestekammion yhdistäminen

Pussin kammioiden nesteet sekoitetaan juuri ennen käyttöä, jolloin saadaan käyttövalmisi liuos.


A)

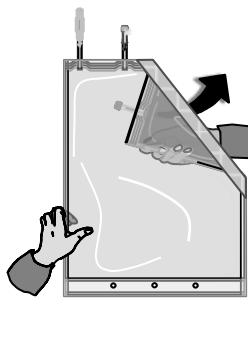

B)

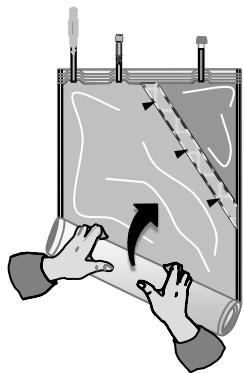

C)

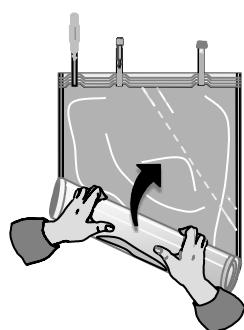

Taita kulmassa oleva pieni kammio auki.

Ala kierittää liuospuissa pieni kammion vastakkaiselta reunalta...

... kunnes kammiot erottava sauma on avautunut koko pituudeltaan ja nesteet sekoittuneet.

Tarkasta kammioiden sekoittamisen jälkeen, että ne erottanut sauma on täysin auki, että liuos on kirkas ja väritön ja että pakaus ei vuoda.

3. Käyttövalmis neste

Käyttövalmis liuos tulee käyttää välittömästi, kuitenkin viimeistään 48 tunnin kuluessa sekoittamisesta.

Käyttövalmisen liuokseen ei saa lisätä mitään, ennen kuin se on kauttaaltaan sekoittunut. Lisäyksen jälkeen liuos on jälleen sekoitettava kunnolla ennen käyttöä.

Natriumkloridiliuos (natriumkloridipitoisuus enintään 30 %) ja injektionesteisiin käytettävä vesi ovat yhteensovivia tämän lääkevalmisten kanssa, ja niitä voidaan tarvittaessa käyttää tasaamaan natriumpitoisuuden muutosnopeutta vaikeissa hyper- tai hyponatreiatapauksissa.

Ellei muuta ole määärätty, käyttövalmis liuos tulisi lämmittää 36,5 °C - 38,0 °C:een juuri ennen infuusiota. Tarkka lämpötila tulee valita kliinisten vaatimusten ja käytetyn teknisen laitteiston mukaan.

Bipackse del: Information till användaren

multiBic 3 mmol/l kalium hemodialysvätska/hemofiltrationsvätska

Läs noge igenom denna bipacksedel innan du börjar använda detta läkemedel. Den innehåller information som är viktig för dig.

- Spara denna bipacksedel, du kan behöva läsa den igen.
- Om du har ytterligare frågor vänd dig till läkare eller sjuksköterska.
- Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Se avsnitt 4.

I den här bipackse delen finns information om följande:

1. Vad multiBic 3 mmol/l kalium är och vad används det för
2. Vad du behöver veta innan du använder multiBic 3 mmol/l kalium
3. Hur multiBic 3 mmol/l kalium används
4. Eventuella biverkningar
5. Hur multiBic 3 mmol/l kalium ska förvaras
6. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

1. Vad multiBic 3 mmol/l kalium är och vad det används för

multiBic 3 mmol/l kalium är en lösning som används för att ta bort restprodukter från kroppen hos män och kvinnor med njursjukdom vid behandling med kontinuerlig njurersättningsterapi. Det används hos patienter med njurskada men också för behandling av förgiftning. Det är mängden kalium (ett salt) i ditt blod som bestämmer vilken typ av lösning du får. Din läkare kommer att kontrollera dina kaliumnivåer regelbundet.

2. Vad du behöver veta innan du använder multiBic 3 mmol/l kalium

Använd inte multiBic 3 mmol/l kalium om

- du är allergisk mot någon av de aktiva substanserna eller något annat innehållsämne i detta läkemedel (anges i avsnitt 6)
- du har hypokalemia (din kaliumnivå är väldigt låg)
- du har metabolisk alkalos (ett tillstånd med för hög nivå av bikarbonat i blodet)
- du inte kan uppnå ett tillräckligt högt blodflöde genom hemofiltret (filtret som används vid blodfiltreringen)
- du har en hög risk för blödning, eftersom läkemedel tillsätts för att förhindra blodkoagulering i hemofiltret

Varningar och försiktighet

Tala med läkare innan du använder multiBic 3 mmol/l kalium.

- Får endast användas efter blandning av de två lösningarna i dubbelkammarpåsen.
- Får under inga omständigheter användas vid temperaturer lägre än rumstemperatur.
- Slangarna som används för att administrera den färdigblandade lösningen ska inspekteras var 30 minuter. Om en fällning (fast material) observeras i slangarna måste påsen och slangsystemet omedelbart bytas ut och patienten övervakas noga.
- Din läkare kommer att kontrollera din vätskebalans (mängden vatten i din kropp), nivåerna av kalium, natrium, andra salter, vissa restprodukter och dina blodsockernivåer. Din läkare kan också ge dig kostråd.

Barn

Användning av multiBic 3 mmol/l kalium hos barn har inte fastställts.

Andra läkemedel och multiBic 3 mmol/l kalium

Tala om för läkare om du tar, nyligen har tagit eller kan tänkas ta andra läkemedel.

Följande interaktioner är tänkbara:

- Skadliga effekter av digitalis (ett läkemedel för att behandla hjärtsjukdom).
- Elektrolytersättningar, parenteral näring (intravenös näringstillförsel) och andra infusionsbehandlingar. Deras effekt på blodets serumkoncentration och vätskestatus måste beaktas vid den här behandlingen.
- Den här behandlingen kan minska blodets koncentration av läkemedel. Justering av dosen kan vara nödvändig.

Graviditet och amning

Om du är gravid eller ammar, tror att du kan vara gravid eller planerar att skaffa barn, rådfråga din läkare innan du använder detta läkemedel.

Det finns inga eller begränsade data användning av multiBic 3 mmol/l kalium hos gravida och ammande kvinnor. Det här läkemedlet ska endast användas under graviditet om din läkare anser det nödvändigt.

Amning rekommenderas inte under behandling med multiBic 3 mmol/l kalium.

3. Hur du använder multiBic 3 mmol/l kalium

Behandling med multiBic 3 mmol/l kalium utförs av sjukvårdspersonal. Din läkare vet hur läkemedlet ska användas.

Om du har ytterligare frågor vänd dig till din läkare.

4. Eventuella biverkningar

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Biverkningar av multiBic 3 mmol/l kalium inkluderar:

- illamående
- kräkningar
- muskelkramp
- ändringar av blodtrycket

Vissa biverkningar kan orsakas av för mycket eller för lite vätska. Dessa är:

- andfåddhet
- svullnad av fotleder och ben
- vätskebrist (t.ex. yrsel, muskelkramper, törstkänsla)
- blodrubbningar (t.ex. störning av blodets saltkoncentration)

Den exakta frekvensen av sådana biverkningar är inte känd (kan inte beräknas från tillgängliga data).

Rapportering av biverkningar

Om du får biverkningar, tala med läkare eller sjuksköterska. Detta gäller även eventuella biverkningar som inte nämns i denna information. Du kan också rapportera biverkningar direkt (se detaljer nedan). Genom att rapportera biverkningar kan du bidra till att öka informationen om läkemedels säkerhet.

I Sverige:

Läkemedelsverket

Box 26
751 03 Uppsala
www.lakemedelsverket.se

I Finland:
Webbplats: www.fimea.fi
Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Biverkningsregistret
PB 55
00034 FIMEA

5. Hur multiBic 3 mmol/l kalium ska förvaras

Förvara detta läkemedel utom syn- och räckhåll för barn.

Förvaras vid lägst 4 °C.

Förvaringsanvisningar efter blandning av de två kamrarnas innehåll:

Den färdigblandande lösningen ska förvaras vid högst 30°C och måste användas inom maximalt 48 timmar.

Används före utgångsdatum som anges på etiketten efter EXP. Utgångsdatumet är den sista dagen i angiven månad.

. Förpackningens innehåll och övriga upplysningar

Innehållsdeklaration

- De aktiva substanserna är kaliumklorid, natriumklorid, natriumvätekarbonat, kalciumkloriddihydrat, magnesiumkloridhexahydrat, glukosmonohydrat.
- Övriga innehållsämnen är vatten för injektionsvätskor, saltsyra 25 %, koldioxid och natriumdivätefosfatdihydrat.

Läkemedlets utseende och förpackningsstorlekar

multiBic 3 mmol/l kalium levereras i en dubbelkammpåse (två kamrar som innehåller olika lösningar). Blandning av de två lösningarna resulterar i den färdigblandade lösningen.

Varje påse innehåller totalt 5000 ml lösning. Den färdigblandade lösningen är klar och färglös.

Varje påse är utrustad med en HF-anslutning, en Luerlock-anslutning och en injektionsport och täcks av en skyddsfolie.

Förpackningsstorlek:
2 påsar à 5000 ml

Innehavare av godkännande för försäljning och tillverkare

Innehavare av godkännande för försäljning
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Else-Kröner-Strasse 1, 61352 Bad Homburg v.d.H,
Tyskland

Tillverkare
Fresenius Medical Care Deutschland GmbH, Frankfurter Strasse 6-8, 66606 St. Wendel, Tyskland

Lokal företrädare (SE)

Fresenius Medical Care Sverige AB
SE-192 51 Sollentuna
Tel: + 46 8 594 776 00

Lokal företrädare (FI):
Fresenius Medical Care Suomi Oy
Puh/tel: +358 9 561 650

Denna bipacksedel ändrade senast:
I Sverige:
I Finland: 12.2.2018

Information endast avsedd för hälso- och sjukvårdspersonal finns i slutet av den här bipacksedeln.

Följande uppgifter är endast avsedda för hälsö- och sjukvårdspersonal

1000 ml färdigblandad lösning innehåller:

Kaliumklorid	0,2237 g
Natriumklorid	6,136 g
Natriumvätekarbonat	2,940 g
Kalciumkloriddihydrat	0,2205 g
Magnesiumkloridhexahydrat	0,1017 g
Glukosmonohydrat	1,100 g
(Glukos)	(1,000 g)
K⁺	3,0 mmol/l
Na ⁺	140 mmol/l
Ca ²⁺	1,5 mmol/l
Mg ²⁺	0,50 mmol/l
Cl ⁻	112 mmol/l
HCO ₃ ⁻	35 mmol/l
Glukos	5,55 mmol/l

pH ≈ 7,4

Teoretisk osmolaritet: (Teor. osmolar.) 298 mOsm/l

Får endast användas om den färdigblandade lösningen är klar och färglös och om påsen och anslutningarna är oskadade.

Endast för engångsbruk. All oanvänt överbliven lösning ska kasseras.

Måste användas med doseringspump.

Bruksanvisning


Lösningen för hemodialys/hemofiltration ska administreras i tre steg:

1. Borttagande av skyddsfolien och noggrann inspektion av hemofiltrationspåsen

Skyddsfolien får inte tas bort förrän strax före användning. Plastförpackningar kan ibland skadas under transport till sjukhuset eller på sjukhuset. Detta kan leda till kontamination och tillväxt av mikroorganismer eller svamp i lösningarna. Alla påsar och lösningar måste därför noggrant inspekteras visuellt före blandning. Även små skador vid förslutningen, svetsningen och hörnen på påsen måste uppmärksammas på grund av risken för kontamination.

2. Blandning av de två kamrarna

De två lösningarna ska blandas omedelbart före användning för att erhålla den färdigblandade lösningen.

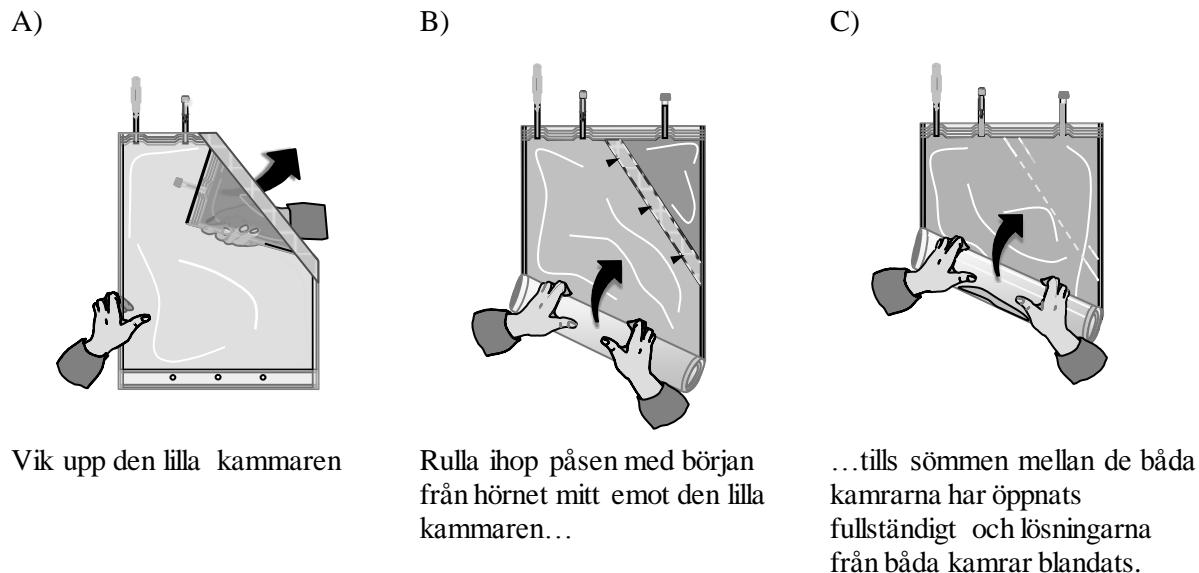

När lösningsarna från de båda kamrarna har blandats är det viktigt att kontrollera att sömnen är helt öppen, att den färdigblandade lösningen är klar och färglös samt att påsen inte läcker.

3. Användning av färdigblandad lösning

Den färdigblandade lösningen måste användas omgående och inom maximalt 48 timmar efter blandning.

Eventuell tillsats till den färdigblandade lösningen måste göras efter det att den färdigblandade lösningen har blandats noga. Efter en eventuell tillsats måste den färdigblandade lösningen noggrant blandas igen före användning.

Blandningar av natriumkloridlösning (koncentration upp till 30 %) eller alternativt vatten för injektionvätskor är kompatibla med det här läkemedlet och kan vid behov användas för att justera natriumkoncentrationen för att begränsa hastiga koncentrationsänderingar vid allvarlig hyper- eller hyponatremi. Se produktresumén för ytterligare information.

Om inget annat förskrivits ska den färdigblandade lösningen värmas till mellan 36,5 °C och 38,0 °C aldeles före infusion. Den exakta temperaturen ska väljas beroende på den kliniska situationen och den tekniska utrustningen som används.